Blazer II™

Cathéters d'ablation à contrôle de température - bidirectionnels - 4 mm

Boston Scientific

Une stabilité à toute épreuve

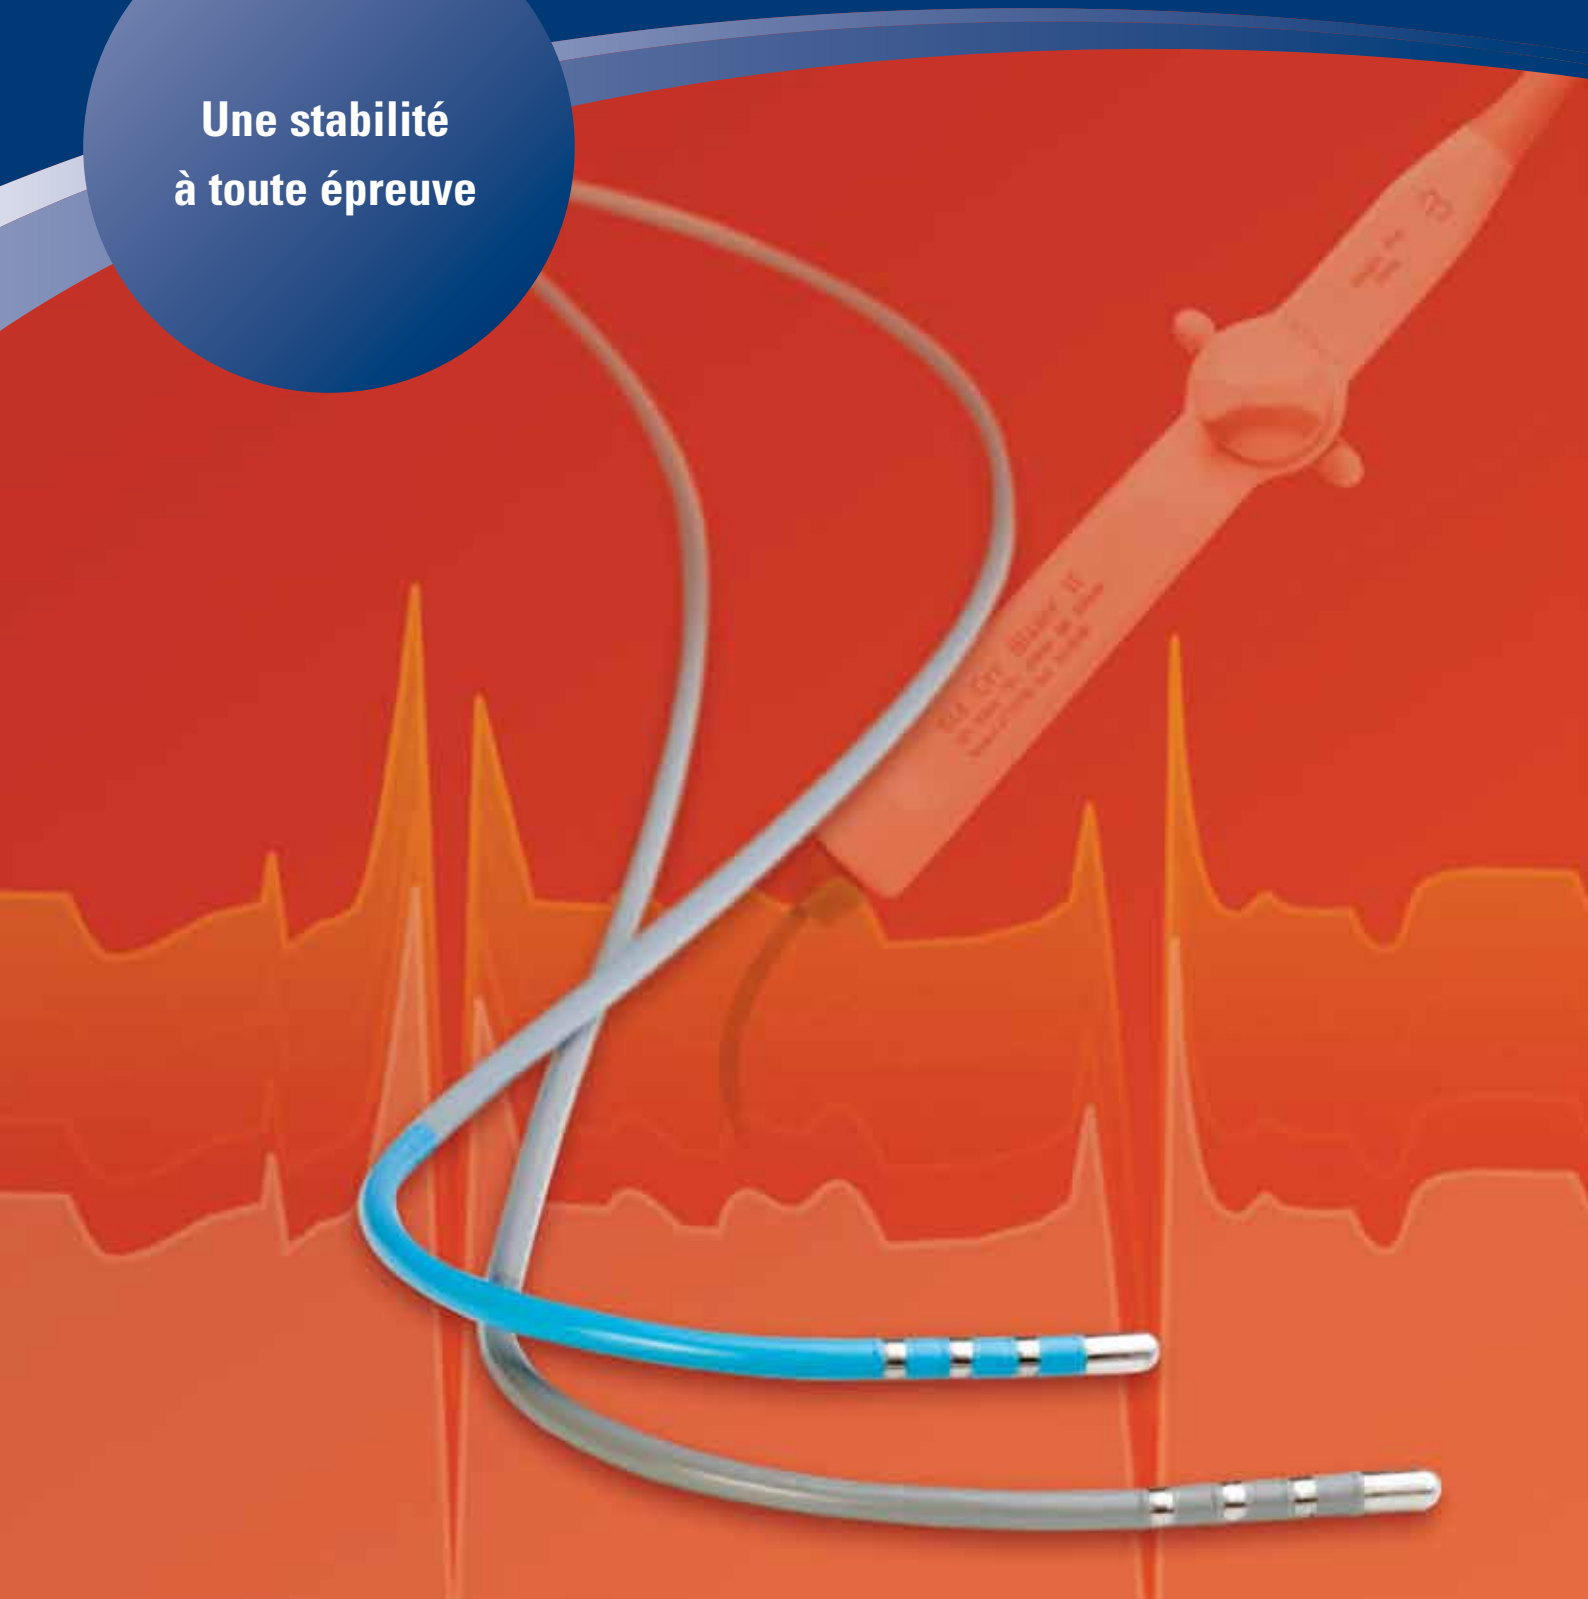

Blazer II™

Cathéters d'ablation à contrôle de température - bidirectionnels - 4 mm

Avantages cliniques et caractéristiques

Les familles de cathéters Blazer II™ et Blazer II HTD™ offrent aux médecins un concept sophistiqué et des performances incomparables*

- Le **système à guidage mécanique** permet un contrôle précis et facilite les micro mouvements de l'électrode distale, permettant ainsi au médecin de déterminer aisément la zone d'ablation souhaitée, c'est-à-dire d'identifier avec précision les points d'activation précoces
- La **bouton de réglage de la tension** permet de bloquer la position de l'électrode distale assurant au médecin qu'elle reste positionnée de façon stable pendant l'ablation
- La **manipulation bidirectionnelle** simplifie l'ablation à proximité des orifices circulaires, tels que les valves et les ostia artériels ou veineux
- La **fonction distale HTD (à torsion élevée)** fournit un meilleur transfert de torsion de la gaine proximale à la gaine distale du cathéter afin de maximiser la force de contact de l'électrode distale au cours de l'ablation
- La **gaine proximale HTD** est conçue pour optimiser la maniabilité et la capacité de torsion du cathéter dans le but de faciliter son évolution à l'intérieur des systèmes vasculaires les plus complexes et d'atteindre la zone d'ablation souhaitée

Caractéristiques techniques

Courbures bi-directionnelles

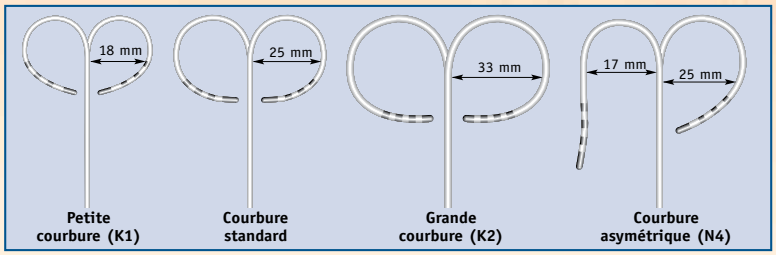

Références de commande

Blazer II™ Cathéters d'ablation à contrôle de température
Longueur du cathéter : 110 cm, espace inter-électrodes : 2,5 mm, quadripolaire

Modèle	Courbure	Electrode distale Ø (F) /Longueur (mm)
Blazer II™ Cathéters d'ablation à contrôle de température (7F)		
M004 **EPT5031TK1** 0	Petite	7F/4 mm
M004 **EPT5031T** 0	Standard	7F/4 mm
M004 **EPT5031TL** 0	Standard	7F/4 mm
M004 **EPT5031TK2** 0	Grande	7F/4 mm
M004 **EPT5031TN4** 0	Asymétrique	7F/4 mm
M004 **EPT5031TM** 0	Standard	7F/4 mm
M004 **EPT5031TMK2** 0	Grande	7F/4 mm
M004 **EPT5031TMN4** 0	Asymétrique	7F/4 mm

* Boston Scientific : données sur fichier.

Blazer II HTD™ Cathéters d'ablation à contrôle de température
Longueur du cathéter : 110 cm, espace inter-électrodes : 2,5 mm, quadripolaire

Modèle	Courbure	Electrode distale Ø (F) /Longueur (mm)
Blazer II HTD™ Cathéters d'ablation à contrôle de température (7F)		
M004 **EPT5031TH** 0	Standard	7F/4 mm
M004 **EPT5031THK2** 0	Grande	7F/4 mm
M004 **EPT5031THN4** 0	Asymétrique	7F/4 mm
M004 **EPT5031THM** 0	Standard	7F/4 mm
M004 **EPT5031THMK2** 0	Grande	7F/4 mm
M004 **EPT5031THMN4** 0	Asymétrique	7F/4 mm

Câbles recommandés pour les cathéters Blazer II™ et Blazer II HTD™ :
M004 **651** 0 ou M004 **613** 0 pour APM (modèle M004 **EPT822T** 0)
M004 **651** 0 pour Pod Maestro 3000™ (modèle M004 **21870T** 0)
L'utilisation d'une plaque de mise à la terre, modèle M004 **354** 0, est requise pour la sécurité du patient.

Commande spéciale : quantité minimale de 25 unités, livraison en 8 à 10 semaines.

Boston Scientific
*Delivering what's next.™***

7F = 2.33 mm

www.bostonscientific-international.com

Toutes les marques déposées mentionnées appartiennent à leurs propriétaires respectifs. AVERTISSEMENT : Conformément à la législation, ce dispositif ne peut être vendu que sous prescription médicale. Les indications, contre-indications, mises en garde et mode d'emploi figurent sur la notice livrée avec chaque dispositif. Informations à n'utiliser que dans les pays avec enregistrements produits des autorités sanitaires applicables.
PSST IC 1663 en parImprimé Applemed/Comevent. **L'avendir dés maintenant. July 2010

© 2010 Boston Scientific Corporation ou ses filiales. Tous droits réservés.
DINEP2088FB